PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbrochure

08.08.2026

KERN 328-09

Milligramlod, F1, 500 mg, plade, poleret rustfrit stål

DANSK

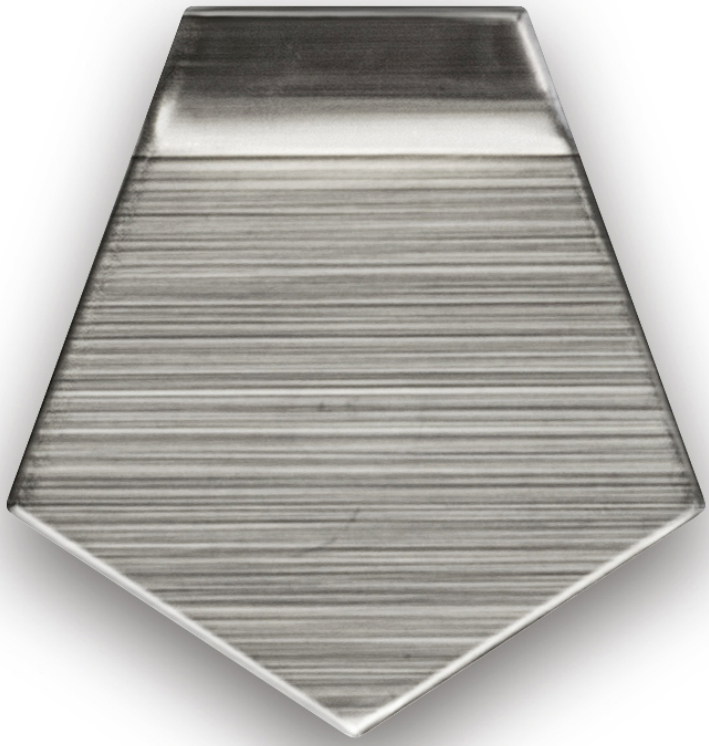

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Tyskland

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

BEMÆRK VED DIN BESTILLING

- Til dette lod anbefaler vi på grund af den meget nøjagtige lodklasse absolut et etui. Et udvalg finder du i afsnittet Tilbehør

PIKTOGRAMMER

Standard | Option





DANSK

TILBEHØR

Model	Beskrivelse
315-242	Pincetter 315-242 (polyamid | 100 mm)
315-243	Pincetter 315-243 (rustfrit stål | 105 mm)
315-247	Pincetter 315-247 (rustfrit stål, plast | 136 mm)
317-009-600	Lodetui i aluminium 317-009-600 (til nominelle værdier 1 mg - 500 mg (enkeltvis) | til klasserne E1 - M3 | til udførelse brøkgram)
318-270	Pensel 318-270
338-090-200	Lodetui i træ 338-090-200 (til nominelle værdier 1 mg - 500 mg (enkeltvis) | til klasserne E1 - M2 | til udførelse knop/kompakt)
347-009-400	Lodetui i plast 347-009-400 (til nominelle værdier 1 mg - 500 mg (enkeltvis) | til klasserne E1 - M2 | til udførelse knop/kompakt)

SERVICEYDELSER

Model	Beskrivelse
920-350	Mærkning med lasergravering (individuel mærkning) KERN 920-350
920-351	Mærkning af kalibreringslodder (sidste cifre i serienummeret) KERN 920-351
921-459	Garanteret plusafvigelse (> +1/3 OIML) KERN 921-459
962-459	DAkkS-kalibreringscertifikat 962-459
962-459R	DAkkS-genkalibrering 962-459R

KERN piktogramoversigt



Pakkeforsendelse med kurer: Den interne produktklargøring varer en dag



Akkrediteret kalibrering (DKD): Den akkrediterede kalibrering varer 3 arbejdsdage